
کد فرم:۳۰۱
تاریخ اجرا:۹۵/۰۲/۱ تاریخ بازنگری: ۹۶/۰۲/۱

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی – درمانی قزوین
اداره تجهیزات پزشکی
فلوچارت اسقاط تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی

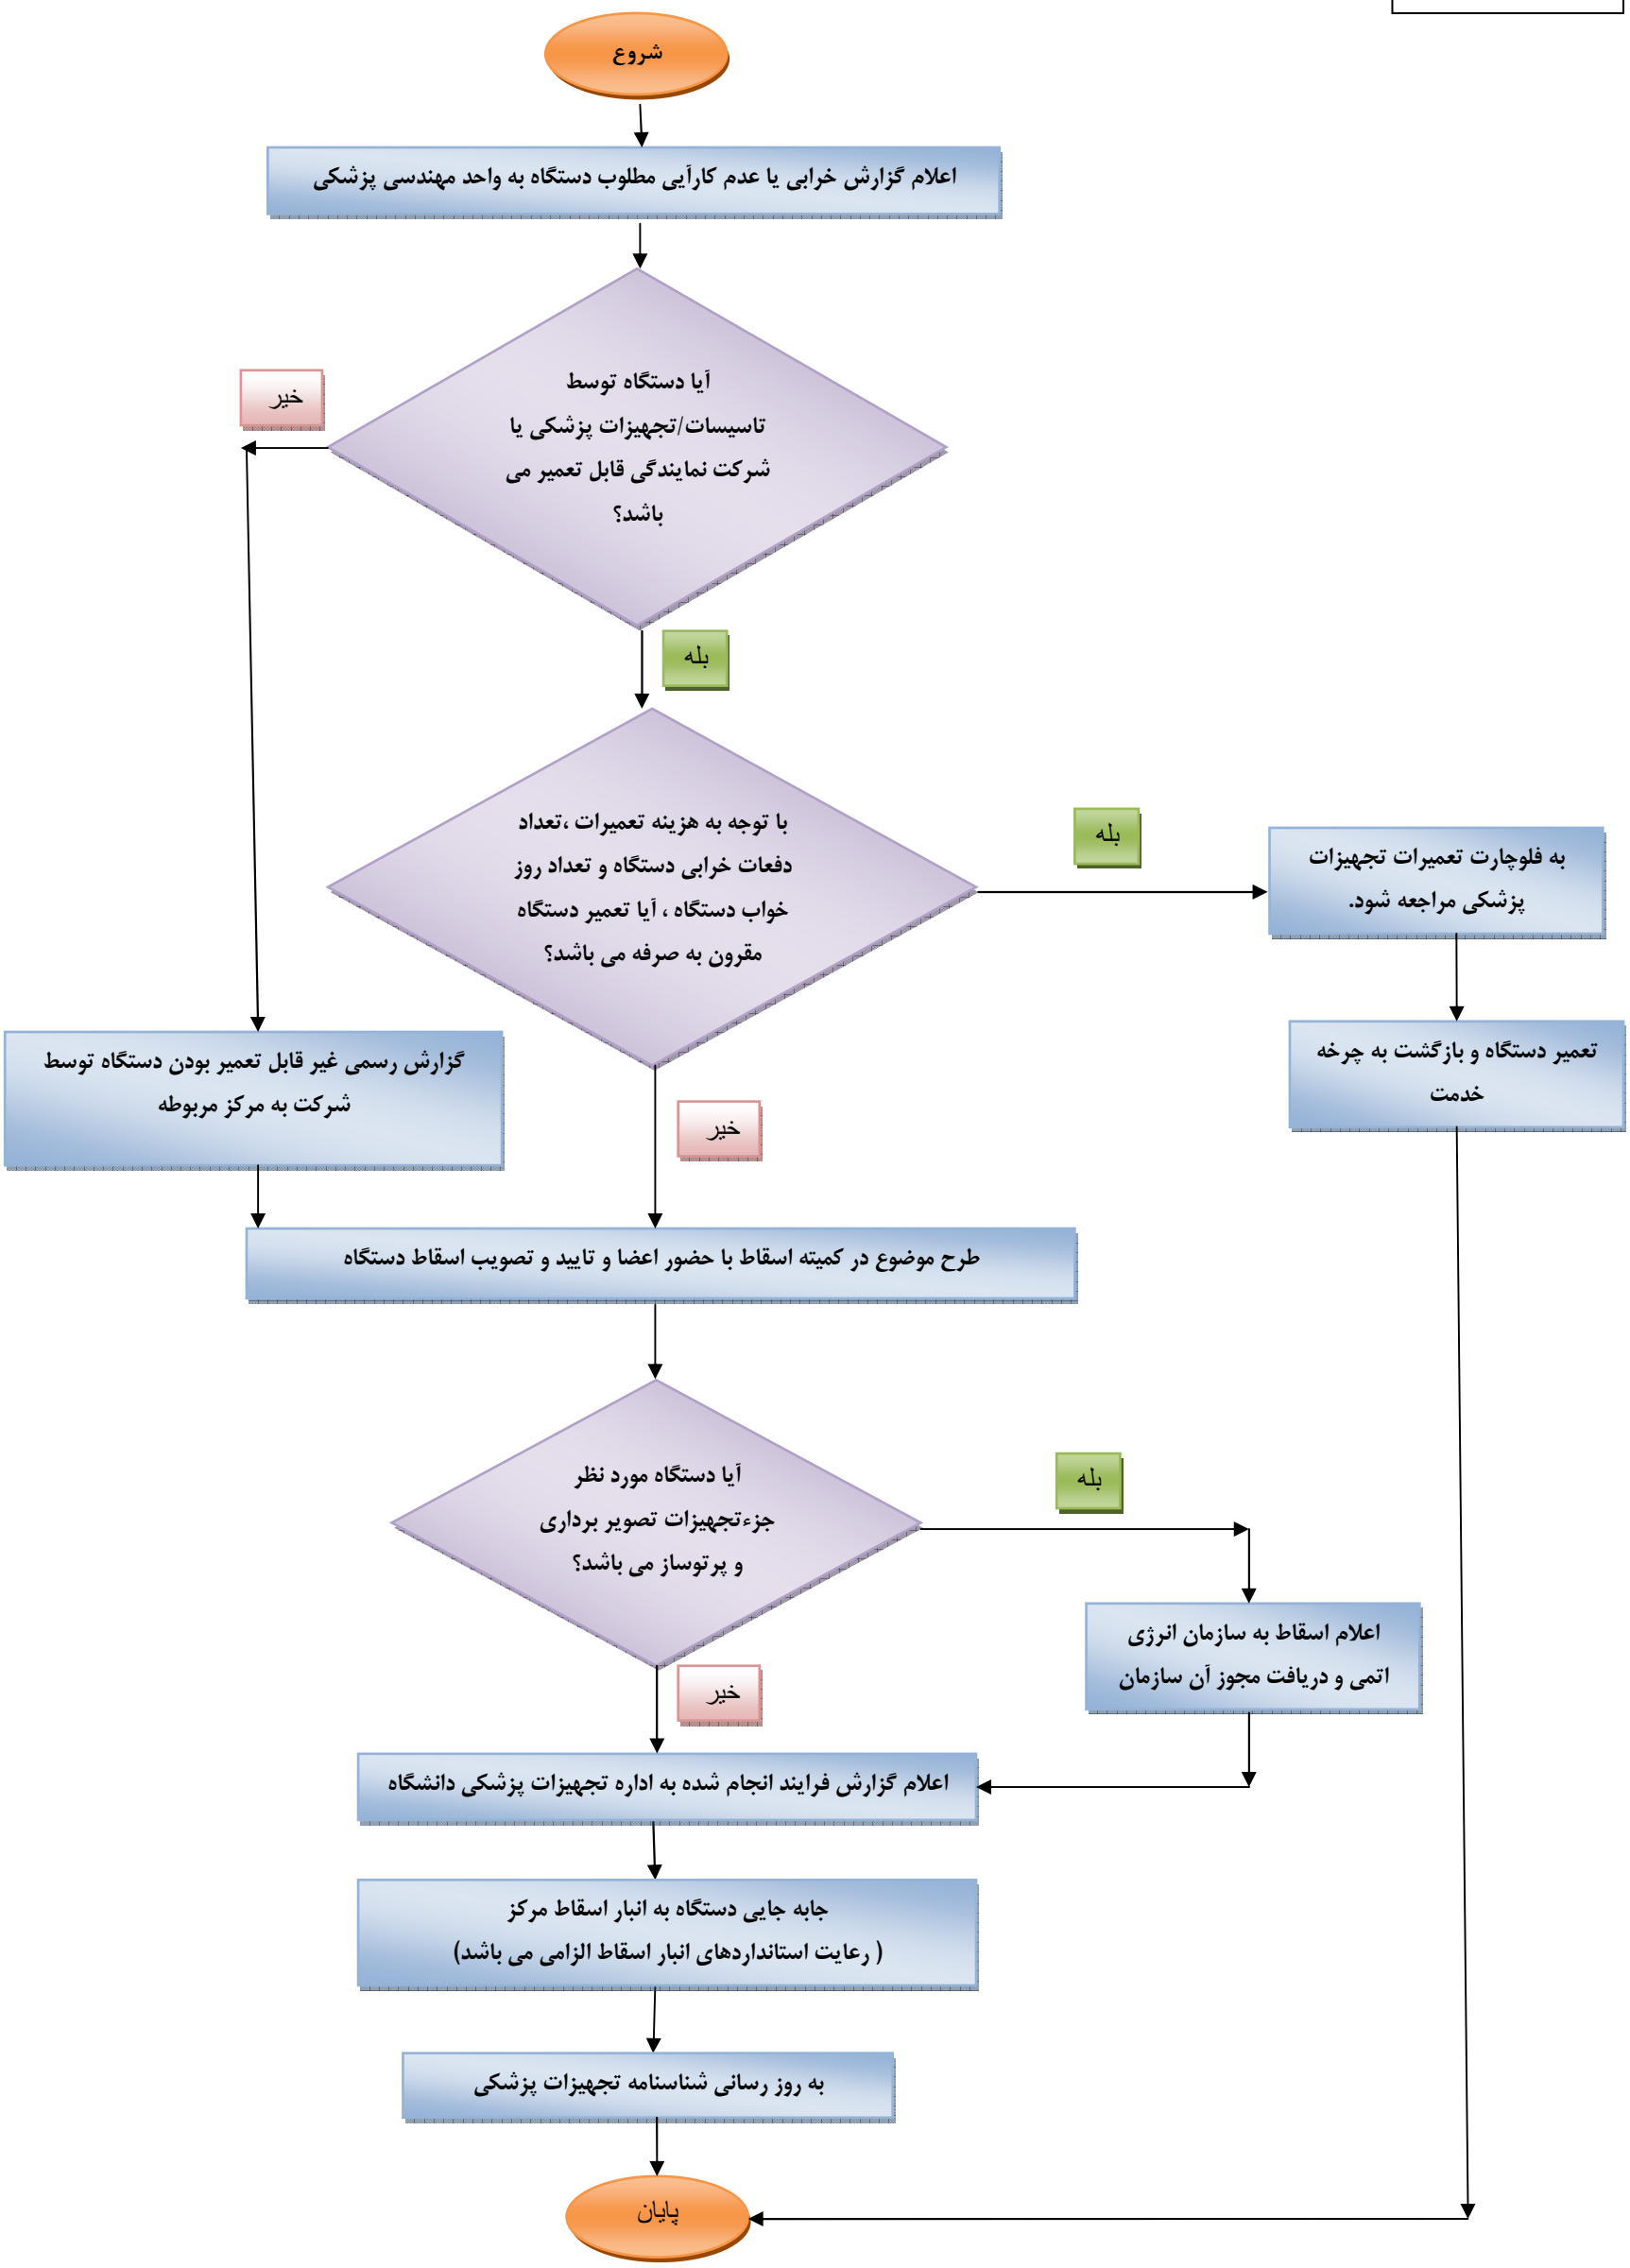

نکته:

۱.اسقاط دستگاه باید با تایید واحد مهندسی پزشکی و از طریق گزارش رسمی نمایندگی های مجاز و در صورت عمر بالای ده سال دستگاه ، از طریق شرکت های ثالث معتبر صورت پذیرد.
۲.استفاده مجدد از قطعات مصرفی دستگاه و سایر قطعاتی که دارای سطح خطر بالا بوده و امکان انتقال عفونت و یا بیماری را تشدید می کنند و به هر شکل و عنوان ممنوع است.
۳. در رابطه با اسقاط تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی به دستورالعمل جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی ابلاغی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مراجعه گردد.
۴. اعضای کمیته اسقاط عبارتند از: ریاست، مدیریت، مترون، مسئول تجهیزات پزشکی، سرپرستار بخش مربوطه و مسئول اموال مرکز